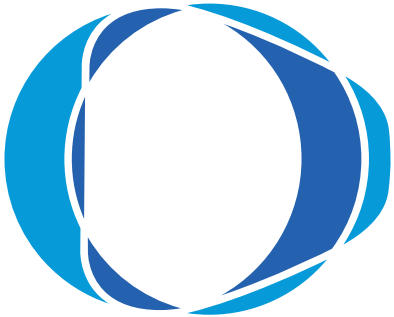

PROSOMNUS®
SLEEP TECHNOLOGIES

ProSomnus® RPMO$_2$ OSA Device

QUICK START GUIDE

Treat Your Sleep Apnea. Capture Insights. Sleep Better.

The ProSomnus® $RPMO_2$ OSA Device delivers clinical-grade insights that empower you to understand your therapy, optimize recovery, manage Obstructive Sleep Apnea, and achieve your sleep goals.

TABLE OF CONTENTS

Introduction 4

Creating Your Account and Downloading the Oxymetrx App 5

Connecting and Charging Your $RPMO_2$ OSA Device 6

Opening the Oxymetrx App and Pairing it with the $RPMO_2$ OSA Device 7

Daily Routine 8

LED Quick Guide 9

Troubleshooting Guide 10

Helpful Tips 11

Welcome to the ProSomnus RPMO$_2$ OSA Device Quick Start Guide. Setting up your new ProSomnus RPMO$_2$ OSA Device is simple, and we're here to help. In this guide, we'll walk you through the steps to get your device up and running and connect it to the ProSomnus Oxymetrx™ App. Note: Further product information is available in the User Manual reachable by scanning the QR code at the end of this guide.

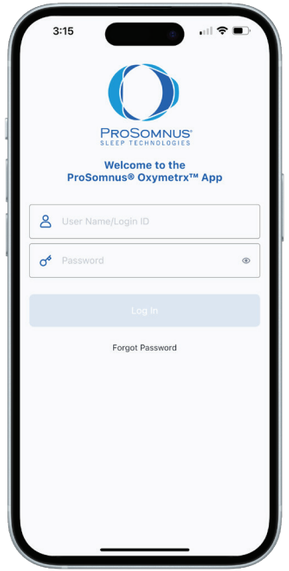

OVERVIEW

Set Up Your RPMO$_2$ OSA Device

1. Create your account online
2. Download the ProSomnus Oxymetrx App
3. Charge your RPMO$_2$ OSA Device
4. Pair your RPMO$_2$ OSA Device with the Oxymetrx App

Wear with Confidence! Establish a Daily Routine

1. Insert your RPMO$_2$ OSA Device before you go to sleep
2. Upon waking, clean your RPMO$_2$ OSA Device
3. Place your RPMO$_2$ OSA Device on the charger to ready it for the next night
4. Open the Oxymetrx App to transfer your data

Creating Your Account and Downloading the Oxymetrx App



When we received your order, an account registration email was sent to you from ProSomnus (No-reply@oxymetrxmail.prosomnus.com) with the subject line "Create Your Account Now". Follow the instructions in the email:

1. Click on the link for the **Oxymetrx Portal** to go to the website and create your account username and password.
2. Save your username and password! You'll use them to log into the app.
3. Now use the App Store link or QR code (provided in the same email) to download the Oxymetrx App from the appropriate App Store for your phone.

Logging In

Use the credentials you just created to log into the app.

If you forget your password, click **Forgot Password** and a change password link will be sent to the email you registered with.

Once logged in you are ready to pair with your RPMO$_2$ OSA Device.

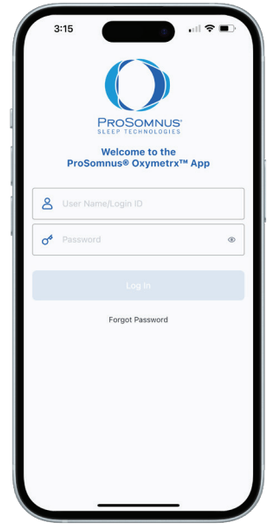

Connecting Your RPMO$_2$ OSA Device

Now that you've signed into the Oxymetrx App, you're ready to set up your device.

Your device will be delivered by the Provider who took your oral scan. They will instruct you on wearing the RPMO$_2$ OSA Device and connecting your new device. Keep these instructions for reference.

Charge Your Device

Your RPMO$_2$ OSA Device must have a charge to connect. Our charging station allows you to conveniently charge your RPMO$_2$ OSA Device wirelessly. Plug in your charger and simply place the device as shown with the flat side down and sensor facing the blue cradle.

When first powered on, the device LED will be solid red, indicating that the device needs to be initialized by connecting to the app. Once the device is connected to the app (in the next step), the device LED will begin blinking green. While charging, the charger light will also blink green and will turn solid once the RPMO$_2$ OSA Device is fully charged. At that point, the RPMO$_2$ OSA Device LED will turn off.

Once your RPMO$_2$ OSA Device is charging you can proceed to pairing the device with your Oxymetrx App.

Refer to the **LED Quick Guide** table at the end for more information on what each LED means.

Open the Oxymetrx App and Pair with the RPMO$_2$ OSA Device

Open the app. Click the plus icon (+) in the upper right corner to scan for your RPMO$_2$ OSA Device.

The app will bring up the Search Device screen where you can begin the connection process. Once connected you will see the icon change to either a RPMO$_2$ OSA Device ( ) or a lightning bolt ( ) if the device is on the charger.

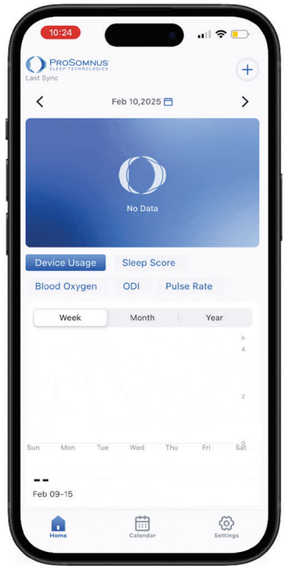

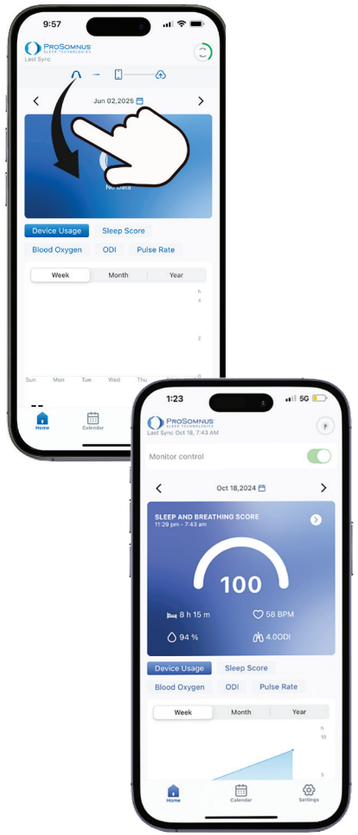

Once you have worn your RPMO$_2$ OSA Device overnight you will be able to transfer the device data to the app and review your sleep data.

Daily Routine

Establishing a daily routine will help you get the most out of your RPMO$_2$ OSA Device.

1. Insert your RPMO$_2$ OSA Device prior to sleep and remove upon waking according to the instructions given to you by the Provider who took your oral scan.
2. Clean your device using a regular soft toothbrush and mild detergent. Rinse thoroughly.
3. Place the device on the charging station, ensuring the green LEDs are blinking, indicating charging.
4. Open your app to upload your data from the device. Animated icons indicate a transfer is in progress. If the data transfer does not begin you can swipe down on the screen to initiate.

5. After the data transfer is complete your sleep data will appear ready for review.

LED QUICK GUIDE

Device LED	Charger LED	Meaning	Action Required
Flashing green light	Flashing green light	Charging in progress	Leave device on charger until charging completes.
Green light on for 15 seconds	Solid green light	Charging complete	Device is ready for use.
Flashes green twice	—	Connecting to app	Wait until connection is established.
Solid green light	—	Firmware upgrade in progress	Do not remove from charger or interrupt process.
Solid red light	—	Device has been reset	Open the app and pair the device to re-initialize its configuration.
Flashing red light	Flashing red light	Fault detected	Contact your healthcare provider.

TROUBLESHOOTING GUIDE

Issue	Possible Cause	Solution
Device will not power on	Battery is depleted	• Fully charge the device on the charging station. • Make sure the LEDs indicate charging.
Device does not charge	Device not correctly placed on the charging station	• Center the device on the charging station. • Slightly adjust the device's position until the charger's LED indicator turns on.
Device not connecting to the app	Bluetooth turned off	• Turn on Bluetooth and retry.
	Device is not registered	• Register the device in the app before connecting.
	Weak connection	• Move the device to your smartphone/tablet (within 3 meters).
	Another device/app connected	• Turn off or disconnect any devices or applications that may have previously connected to the device. • Attempt to discover the device again using the app.
No data appearing in the app	Data upload not completed	• Open the app and connect to the device after removing it in the morning.
Red light flashing on device or charger	Device fault detected	• Remove from use and contact your healthcare provided.
Solid red light on the device	Device has been reset	• Open the app and pair the device to re-initialize its configuration.

IMPORTANT: Record your username here _____

If you lose your username you will need to contact **RPMSupport@ProSomnus.com** in order to retrieve it.

Helpful Tips

Based on the amount of data collected, data transfer can take several minutes. Many users find it helpful to build this into their morning routine, taking a shower or getting dressed while the data uploads.

The charging station was designed for convenient storage of your device's lower arch while charging the upper arch containing the sensor. Use the blue lip as the platform to hold the lower arch. Ensure the unit remains charging by confirming the LED indicators are both green.

PROSOMNUS®
SLEEP TECHNOLOGIES

PATENTED

MADE IN U S A

ProSomnus® is a Registered Trademark. ProSomnus, the "O" logo design and the artwork and designs contained herein are trademarks and copyrights of ProSomnus Sleep Technologies, Inc. and may not be reproduced, distributed, displayed, published, altered or used without prior written consent. All other products and company names mentioned herein are trademarks of their respective owners.

prosomnus.com/patents

PRO3-597-A (January 2026)

ProSomnus Sleep Technologies
5675 Gibraltar Drive
Pleasanton, CA 94588, USA

Main +1 844 537 5337 | ProSomnus.com

Scan For User Manuals

PROSOMNUS®
SLEEP TECHNOLOGIES

ProSomnus® RPMO$_2$ OSA Device

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

Traitez votre apnée du sommeil.
Recueillez des informations.
Dormez mieux.

Le ProSomnus® RPMO₂ OSA Device fournit des informations de qualité médicale qui vous permettent de comprendre votre thérapie, d'optimiser le rétablissement, de gérer l'apnée obstructive du sommeil et d'atteindre vos objectifs de sommeil.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction 4

Création de votre compte et téléchargement de l'application Oxymetrx 5

Connexion et charge de votre RPMO₂ OSA Device 6

Ouverture de l'application Oxymetrx et jumelage de cette dernière avec le RPMO₂ OSA Device 7

Routine quotidienne 8

Guide rapide des DEL 9

Guide de résolution des problèmes 10

Conseils pratiques 11

Bienvenue au guide de démarrage rapide du ProSomnus RPMO₂ OSA Device.
La configuration de votre nouveau ProSomnus RPMO₂ OSA Device est simple et nous sommes là pour vous aider. Dans ce guide, nous vous présenterons les étapes qui vous permettront de faire fonctionner votre dispositif et de le connecter à l'application ProSomnus Oxymetrx™.
Remarque : Des informations complémentaires sur le produit sont disponibles dans le manuel d'utilisation accessible en numérisant le code QR figurant à la fin de ce manuel.

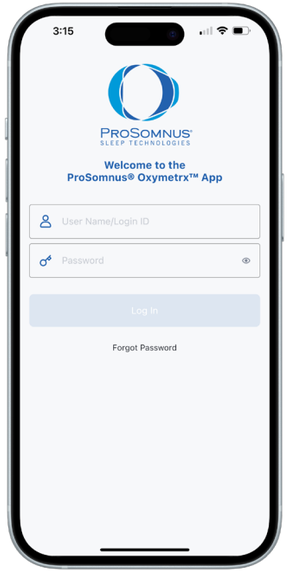

VUE D'ENSEMBLE

Configurez votre RPMO₂ OSA Device

1. Créez votre compte en ligne
2. Téléchargez l'application ProSomnus Oxymetrx
3. Chargez votre RPMO₂ OSA Device
4. Jumelez votre RPMO₂ OSA Device avec l'application Oxymetrx

Portez-le en toute confiance! Établissez une routine quotidienne

1. Mettez votre RPMO₂ OSA Device avant d'aller vous coucher
2. Lorsque vous vous réveillez, nettoyez votre RPMO₂ OSA Device
3. Placez votre RPMO₂ OSA Device sur le chargeur pour le préparer pour la nuit suivante
4. Ouvrez l'application Oxymetrx pour transférer vos données

Création de votre compte et téléchargement de l'application Oxymetrx

Lorsque nous avons reçu votre commande, un courriel d'enregistrement du compte vous a été envoyé de la part de ProSomnus (No-reply@oxymetrxmail.prosomnus.com) avec comme objet « Créez votre compte maintenant ».
Suivez les instructions contenues dans le courriel :

1. Cliquez sur le lien vers le **Portail Oxymetrx** afin d'accéder au site Web et de créer le nom d'utilisateur et le mot de passe de votre compte.
2. Enregistrez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe! Vous les utiliserez pour vous connecter à l'application.
3. Utilisez maintenant le lien vers la boutique d'applications ou le code QR (fourni dans le même courriel) pour télécharger l'application Oxymetrx depuis la boutique d'applications appropriée pour votre téléphone intelligent.



Connexion

Utilisez les informations d'identification que vous venez de créer pour vous connecter à l'application.

Si vous oubliez votre mot de passe, cliquez sur **Forgot Password (Mot de passe oublié)** et un lien de modification du mot de passe sera envoyé au courriel avec lequel vous vous êtes enregistré.

Une fois connecté, vous êtes prêt pour le jumelage de votre RPMO₂ OSA Device.

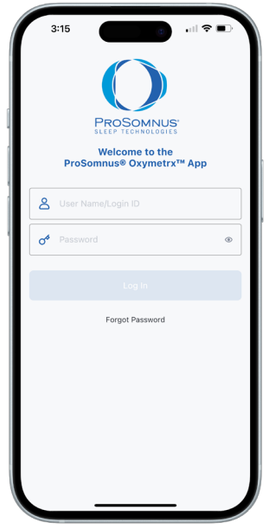

Connexion de votre RPMO₂ OSA Device

Maintenant que vous vous êtes connecté à l'application Oxymetrx, vous êtes prêt à configurer votre dispositif.

Votre dispositif sera fourni par le prestataire qui a effectué votre examen bucco-dentaire. Il vous donnera des informations sur la façon de porter et de connecter votre RPMO₂ OSA Device. Conservez ces instructions pour vous y référer.

Chargez votre dispositif

Votre RPMO₂ OSA Device doit être chargé pour se connecter. Notre station de chargement vous permet de recharger commodément votre RPMO₂ OSA Device via une liaison sans fil. Branchez votre chargeur et placez simplement le dispositif comme indiqué avec le côté plat vers le bas et le capteur orienté vers le socle bleu.

Lorsque le dispositif est mis sous tension pour la première fois, la DEL du dispositif est rouge fixe, indiquant que le dispositif doit être initialisé en le connectant à l'application. Une fois le dispositif connecté à l'application (dans l'étape suivante), la DEL du dispositif commence à clignoter en vert. Pendant la charge, le voyant du chargeur clignote également en vert et devient fixe une fois le RPMO₂ OSA Device complètement chargé. À ce stade, la DEL du RPMO₂ OSA Device s'éteint.

Une fois que votre RPMO₂ OSA Device est en charge, vous pouvez passer à l'appairage du dispositif avec votre application Oxymetrx.

Référez-vous au tableau **Guide rapide des DEL** à la fin de ce manuel pour de plus amples informations sur la signification de chaque DEL.

Ouvrez l'application Oxymetrx et jumelez-la avec le RPMO₂ OSA Device

Ouvrez l'application. Cliquez sur l'icône plus (+) en haut à droite pour numériser à la recherche de votre RPMO₂ OSA Device.

L'application ouvre l'écran Searching for Device (Rechercher le dispositif) dans lequel vous pouvez commencer le processus de connexion. Une fois la connexion établie, l'icône deviendra un RPMO₂ OSA Device ( ) ou un éclair ( ) si le dispositif est sur le chargeur.

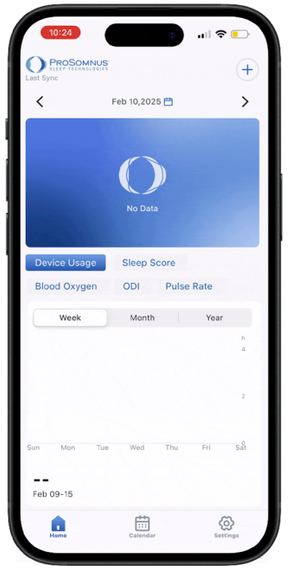

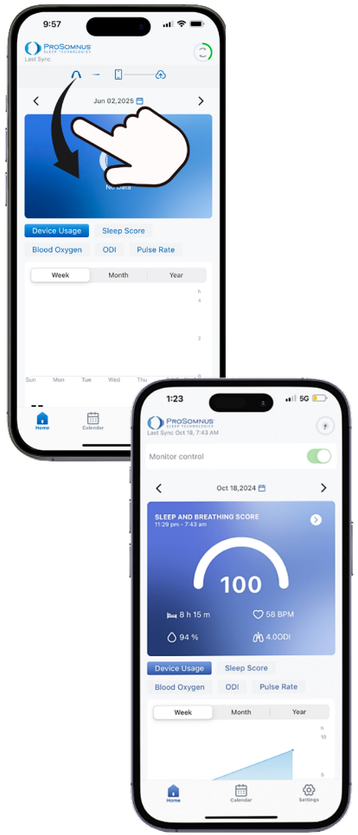

Une fois que vous aurez porté votre RPMO₂ OSA Device pendant la nuit, vous serez en mesure de transférer ses données vers l'application et de passer en revue les données sur votre sommeil.

Routine quotidienne

L'établissement d'une routine quotidienne vous aidera à tirer le meilleur parti de votre RPMO₂ OSA Device.

1. Mettez votre RPMO₂ OSA Device avant de dormir et retirez-le en vous réveillant conformément aux instructions qui vous ont été données par le prestataire qui a effectué votre examen bucco-dentaire.
2. Nettoyez votre dispositif à l'aide d'une brosse à dents souple ordinaire et d'un détergent doux. Rincez avec soin.
3. Placez le dispositif sur la station de charge en vous assurant que les DEL vertes clignotent, indiquant que la charge est en cours.
4. Ouvrez votre application pour transmettre vos données depuis le dispositif. Des icônes animées indiquent qu'un transfert est en cours. Si le transfert de données ne commence pas, vous pouvez balayer vers le bas sur l'écran pour le démarrer.

5. Une fois le transfert de données terminé, les données sur votre sommeil sont affichées, prêtes à être passées en revue.

GUIDE RAPIDE DES DEL

DEL du dispositif	DEL du chargeur	Signification	Action requise
Voyant vert clignotant	Voyant vert clignotant	Recharge en cours	Laissez le dispositif sur le chargeur jusqu'à la fin de la recharge.
Voyant vert allumé pendant 15 secondes	Voyant vert fixe	Recharge terminée	Le dispositif est prêt à être utilisé.
Clignote deux fois en vert	–	Connexion à l'application en cours	Attendez jusqu'à ce que la connexion soit établie.
Voyant vert fixe	–	Mise à jour du micrologiciel en cours	Ne retirez pas de la station de chargement et n'interrompez pas le processus.
Voyant rouge fixe	–	Le dispositif a été réinitialisé	Ouvrez l'application et jumelez le dispositif pour réinitialiser sa configuration.
Voyant rouge clignotant	Voyant rouge clignotant	Panne détectée	Contactez votre prestataire de soins de santé.

GUIDE DE RÉSOLUTION DES PROBLÈMES

Problème	Cause possible	Solution
Le dispositif ne se met pas sous tension	La batterie est épuisée	• Chargez complètement le dispositif sur la station de chargement. • Assurez-vous que les DEL indiquent la charge.
Le dispositif ne se recharge pas	Dispositif placé de manière incorrecte sur la station de chargement	• Centrez le dispositif sur la station de chargement. • Ajustez légèrement la position du dispositif jusqu'à ce que l'indicateur DEL de la station de chargement s'allume.
Le dispositif ne se connecte pas à l'application	Bluetooth désactivé	• Activez le Bluetooth et réessayez.
	Le dispositif n'est pas enregistré	• Enregistrez le dispositif dans l'application avant de le connecter.
	Connexion faible	• Déplacez le dispositif vers votre téléphone intelligent/ tablette (à moins de 3 mètres).
	Autre dispositif/application connecté	• Mettez hors tension ou déconnectez les dispositifs ou les applications qui ont pu se connecter précédemment au dispositif. • Tentez de découvrir de nouveau le dispositif à l'aide de l'application.
Aucune donnée ne s'affichent dans l'application	Transmission des données non effectuée	• Ouvrez l'application et connectez le dispositif après l'avoir retiré le matin.
Voyant rouge clignotant sur le dispositif ou la station de chargement	Panne du dispositif détectée	• Cessez de l'utiliser et contactez votre prestataire de soins de santé.
Voyant rouge fixe sur le dispositif	Le dispositif a été réinitialisé	• Ouvrez l'application et jumelez le dispositif pour réinitialiser sa configuration.

IMPORTANT : Écrivez votre nom d'utilisateur ici _____

Si vous oubliez votre nom d'utilisateur, vous devrez contacter **RPMSupport@ProSomnus.com** afin de le récupérer.

Conseils pratiques
Selon la quantité de données recueillies, le transfert de données peut prendre plusieurs minutes. De nombreux utilisateurs trouvent utile de l'intégrer dans leur routine matinale, lorsqu'ils prennent une douche ou lorsqu'ils s'habillent pendant la transmission des données.

La station de chargement a été conçue pour loger commodément l'arc inférieur de votre dispositif pendant la recharge de l'arc supérieur contenant le capteur. Utilisez la languette bleue comme plateforme pour maintenir l'arc inférieur. Assurez-vous que la recharge de l'unité se poursuit en vérifiant que les voyants à DEL sont tous les deux verts.

PROSOMNUS®
SLEEP TECHNOLOGIES

PATENTED

MADE IN USA

ProSomnus® est une marque déposée. ProSomnus, la conception du logo « O » ainsi que les illustrations et les dessins figurant aux présentes sont des marques commerciales et des droits d'auteur de ProSomnus Sleep Technologies, Inc. et ne peuvent pas être reproduits, distribués, affichés, publiés, altérés ou utilisés sans un consentement écrit préalable. Tous les autres noms de produits et de sociétés mentionnés aux présentes sont des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.

prosomnus.com/patents

PRO3-606-A (January 2026)

ProSomnus Sleep Technologies
5675 Gibraltar Drive
Pleasanton, CA 94588, États-Unis

Téléphone principal +1 844 537 5337 | ProSomnus.com

À numériser pour accéder aux manuels d'utilisation